INSTRUCCIONES DE USO

LEQEMBI IQLIK® (leh-kem'-bi ai-klik)
(lecanemab-irmb)
de 360 mg/1.8 ml,

inyección para uso subcutáneo,
autoinyector precargado de dosis única

Estas Instrucciones de uso contienen información sobre cómo preparar y usar LEQEMBI IQLIK de 360 mg/1.8 ml.

Antes de cada uso de LEQEMBI IQLIK

Lea estas Instrucciones de uso antes de comenzar a usar LEQEMBI IQLIK y cada vez que renueve su receta. Puede haber información nueva. Esta información no reemplaza la conversación con su proveedor de atención médica sobre su afección médica o su tratamiento.

Después de la administración de al menos 2 dosis consecutivas de LEQEMBI IQLIK con la orientación directa de su proveedor de atención médica, se decidirá si es adecuado que sea usted o un cuidador quien administre LEQEMBI IQLIK. Su proveedor de atención médica debe mostrarle a usted o a un cuidador cómo usar LEQEMBI IQLIK de la manera correcta antes de la primera administración. Si tiene alguna pregunta sobre cómo usar el autoinyector, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Información importante


- LEQEMBI IQLIK solo se administra como inyección debajo de la piel (subcutánea).
- **No** retire la tapa transparente hasta que esté listo para aplicar la inyección.
- **No** intente desarmar el autoinyector en ningún momento.
- **No** reutilice el autoinyector.
- **No** aplique la inyección a través de la ropa.
- **No** agite el autoinyector.
- **No** use el autoinyector si la caja o cualquier pieza parecen tener daños o si se han caído.
- **No** sostenga el autoinyector por la tapa de la aguja de color magenta.

Almacenamiento de LEQEMBI IQLIK


- Almacene el autoinyector LEQEMBI IQLIK en un refrigerador entre 36 °F y 46 °F (entre 2 °C y 8 °C).
- **No** congelar.
- Mantenga el autoinyector LEQEMBI IQLIK en la caja original hasta que esté listo para usar, para protegerlo de la luz.
- LEQEMBI IQLIK se puede almacenar a temperatura ambiente hasta 77 °F (25 °C) durante un máximo de 14 días en la caja original. **No** lo vuelva a guardar en el refrigerador si se ha llevado a temperatura ambiente.
- Deseche (elimine) el LEQEMBI IQLIK que esté vencido o si no se almacenó de la manera correcta.
- Mantenga el autoinyector LEQEMBI IQLIK y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

El autoinyector LEQEMBI IQLIK de 360 mg

Antes de usar

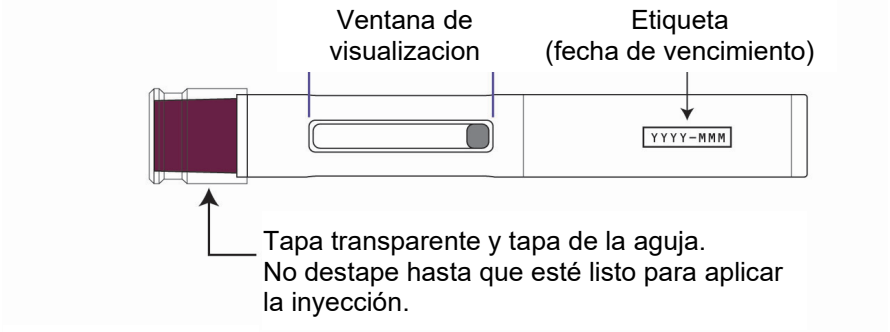


Después de usar

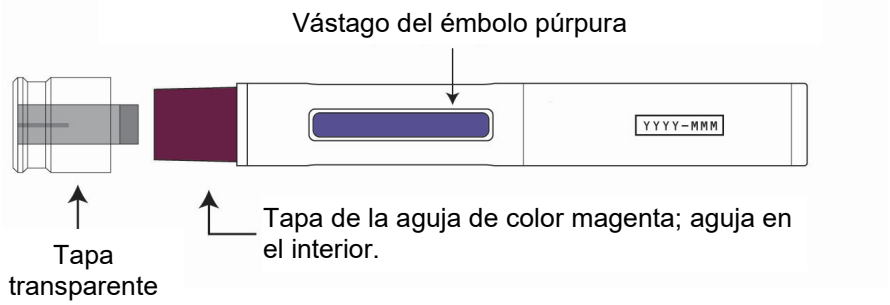

Reunir los suministros

Suministros incluidos




1 autoinyector
LEQEMBI IQLIK


Suministros no incluidos




Paño humedecido con alcohol



Trozo de algodón o gasa



Recipiente para desecho de objetos cortopunzantes




Venda adhesiva

Preparación para la inyección de LEQEMBI IQLIK

Paso 1
Retire la caja del refrigerador y **espere 20 minutos** para que el autoinyector alcance la temperatura ambiente. **No** intente acelerar el proceso de calentamiento de ninguna manera porque el producto puede dañarse.

Controle la caja.

- **No** usar si ya pasó la fecha de vencimiento que figura en la caja.
- **No** usar si el sello de la caja está roto.

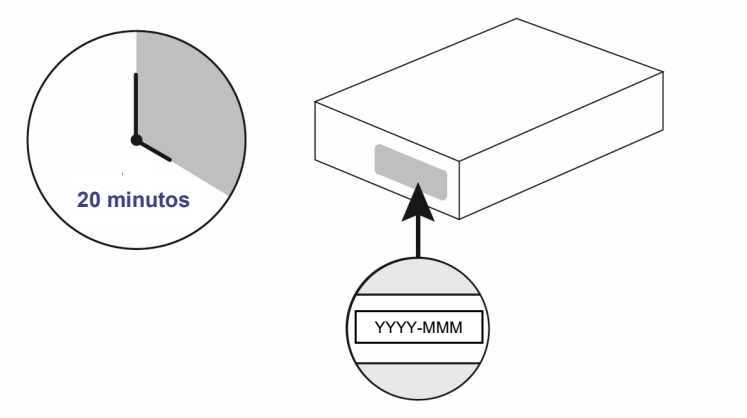

Paso 2
Verifique el autoinyector.


- **No** utilice el autoinyector si está dañado o si se ha caído.

Verifique la ventana de visualización.


- **No** utilice el medicamento si tiene un aspecto turbio, presenta un cambio de color o si contiene partículas. El medicamento debe ser transparente e incoloro a amarillo pálido. Es normal ver burbujas de aire en la ventana.

Verifique la fecha de vencimiento.

- **No** usar si ya pasó la fecha de vencimiento del autoinyector.

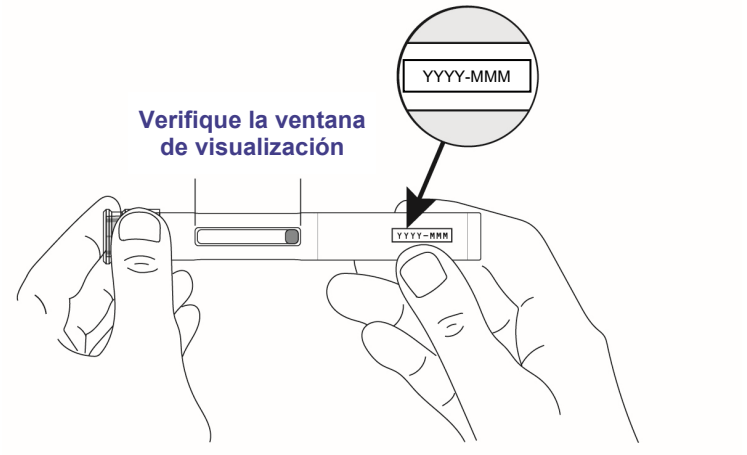


Paso 3
Lávese las manos con agua y jabón o use desinfectante para manos.

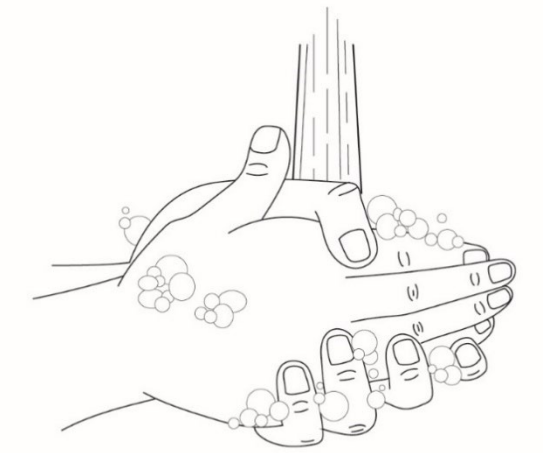

Paso 4

Puede inyectarse en la parte delantera de los muslos o en el área del estómago (abdomen). Si un proveedor de atención médica o un cuidador le administra la inyección, también puede hacerlo por detrás de la parte superior del brazo.

- **No** aplique la inyección sobre lunares, cicatrices, moretones, tatuajes o en zonas donde la piel esté enrojecida, endurecida, sensible o lesionada.
- Utilice otro lugar de inyección a 1 pulgada, como mínimo, del último lugar cada vez que use LEQEMBI IQLIK.
- **No** aplique la inyección en el área de 2 pulgadas alrededor del ombligo.

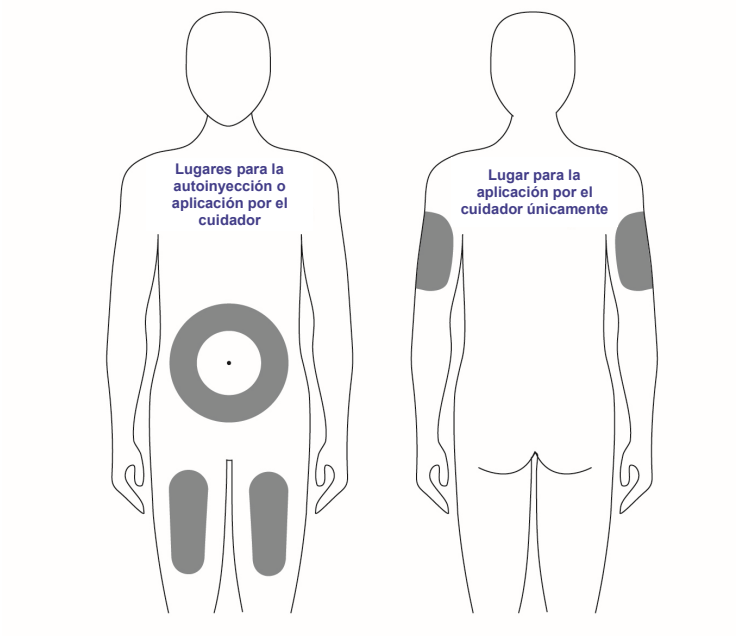


Inyección de LEQEMBI IQLIK

Paso 5

Limpie el lugar de la inyección con un paño humedecido con alcohol y deje que la piel se seque al aire.

- **No** toque el lugar de la inyección después de limpiarlo.
- **No** abanique ni sople en el área limpia.

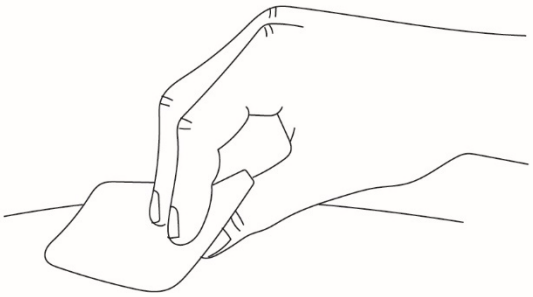


Paso 6


Retire la tapa transparente cuando esté listo para aplicar la inyección.

Sostenga el autoinyector con una mano y retire firmemente la tapa transparente tirando recto con la otra mano.

- **No** doble ni gire la tapa transparente mientras la retira.
- **No** coloque los dedos ni la mano sobre la aguja. Hacer esto puede provocar una lesión con la aguja.
- **No** vuelva a colocar la tapa transparente después de que la haya retirado del autoinyector.

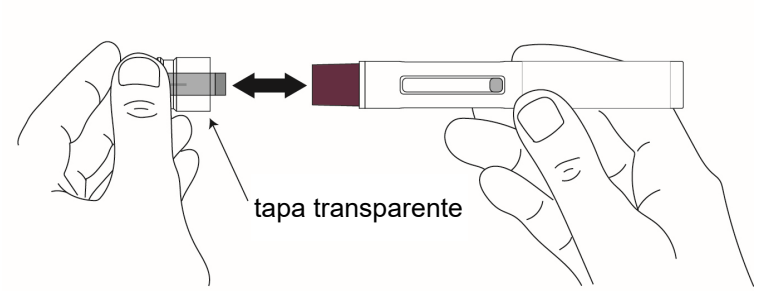


Paso 7
Deseche (elimine) la tapa en la basura doméstica o en el recipiente para desecho de objetos cortopunzantes.

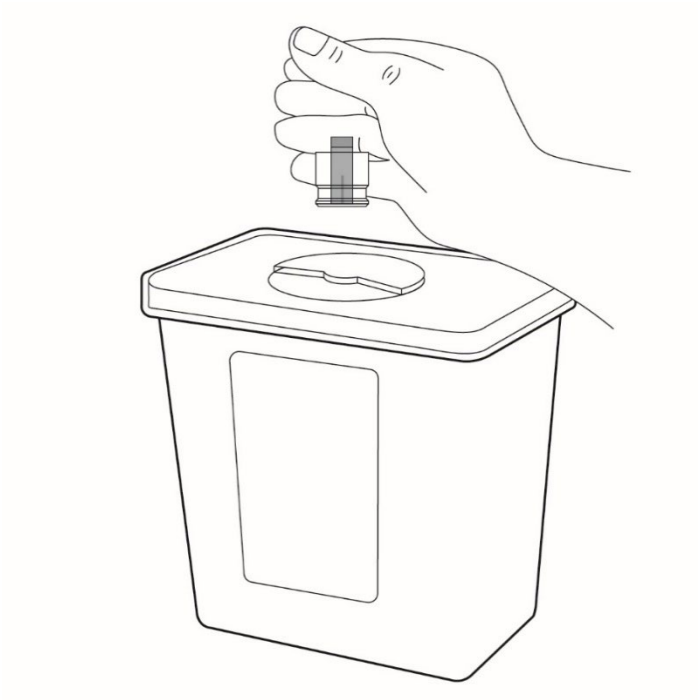

Paso 8
Coloque la tapa de la aguja de color magenta en un ángulo de 90 grados contra la piel. Asegúrese de poder ver la ventana de visualización.

- **No** aplique la inyección a través de la ropa.

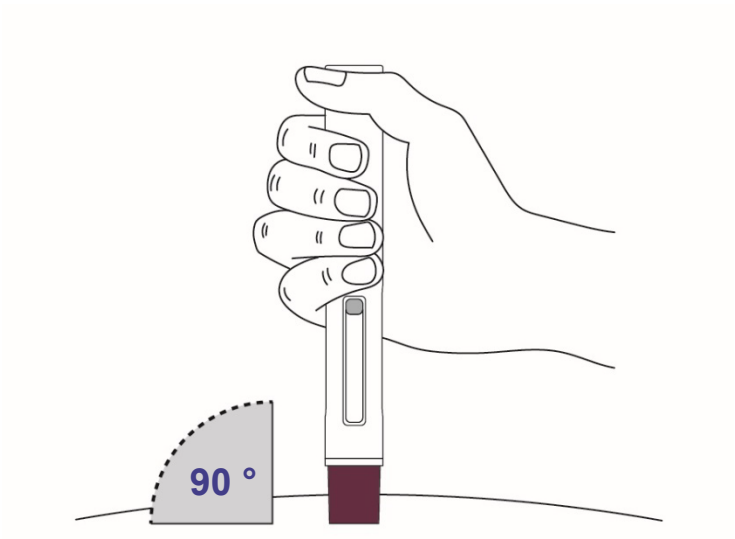


Paso 9
Empuje el autoinyector firmemente contra la piel para iniciar la inyección.

La inyección comenzará automáticamente.


- Es posible que escuche un primer “clic” que indica el inicio de la inyección.
- Durante la inyección, el vástago del émbolo púrpura se moverá hacia abajo en la ventana de visualización.

Si no escucha el clic, observe el vástago del émbolo púrpura mientras se mueve hacia abajo.

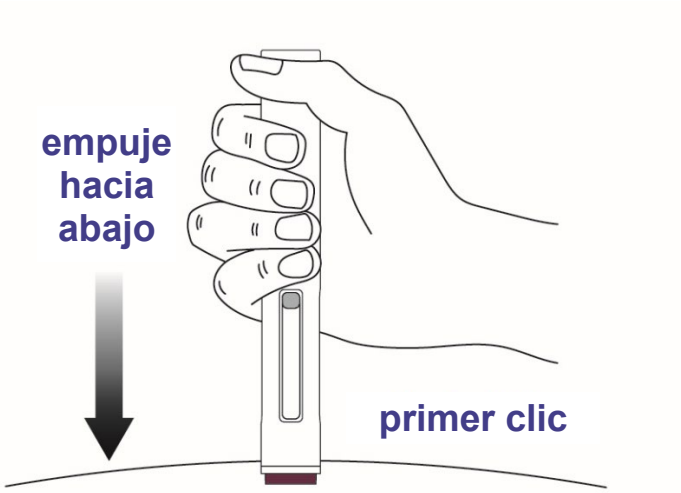


Paso 10
Continúe sosteniendo el autoinyector contra la piel durante aproximadamente **10 segundos**. Escuchará un segundo clic. El vástago del émbolo púrpura llenará la ventana de visualización.

La inyección está completa, pero continúe sosteniendo el autoinyector.

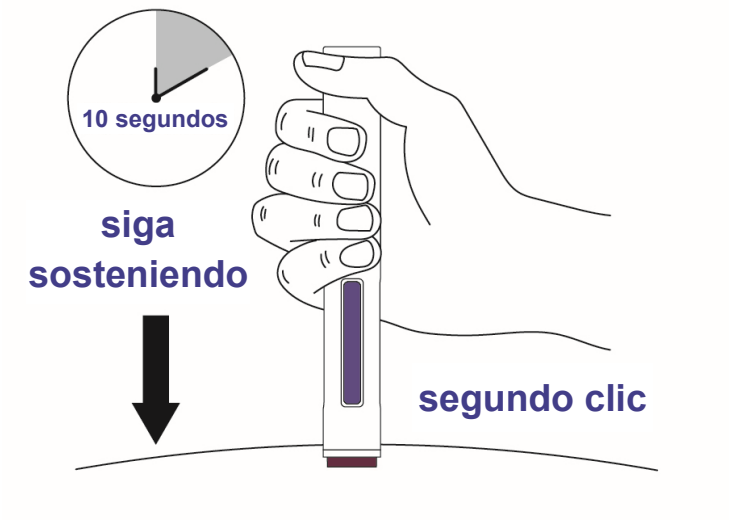


Paso 11
Mantenga el autoinyector en su lugar **durante al menos 5 segundos más** después de que termine la inyección.

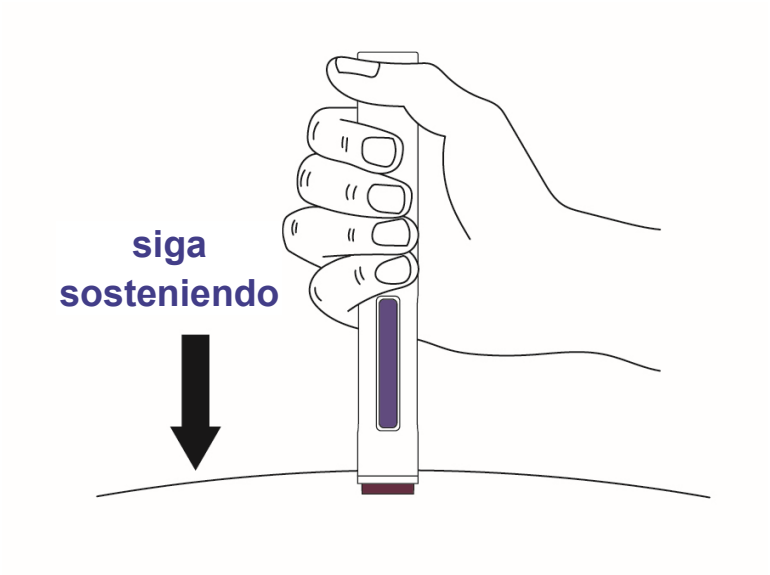


Paso 12
Retire el autoinyector tirando de él hacia arriba respecto del lugar de la inyección.

- La tapa de la aguja de color magenta se moverá automáticamente a su lugar para cubrir la aguja.

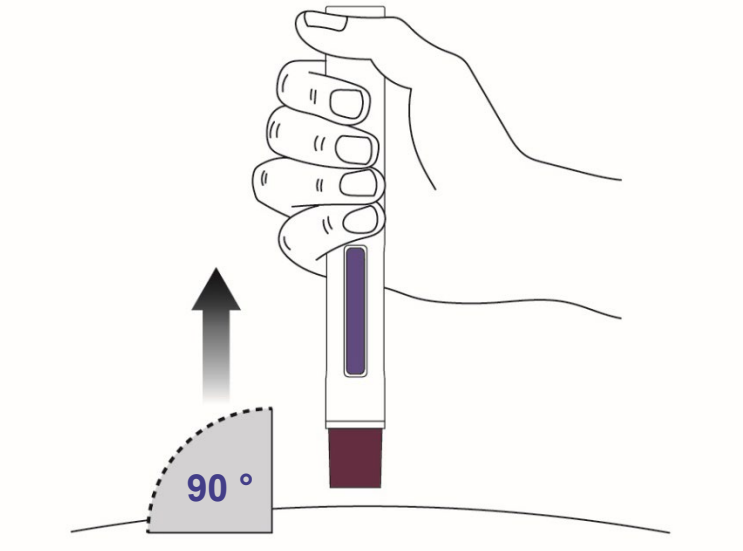


Paso 13
Es posible que note una pequeña gota de sangre en el lugar de la inyección. Esto es normal. Presione el área con un trozo de algodón o gasa.

- Si es necesario, cubra el lugar de la inyección con una venda adhesiva.
- **No** frote el lugar de la inyección.

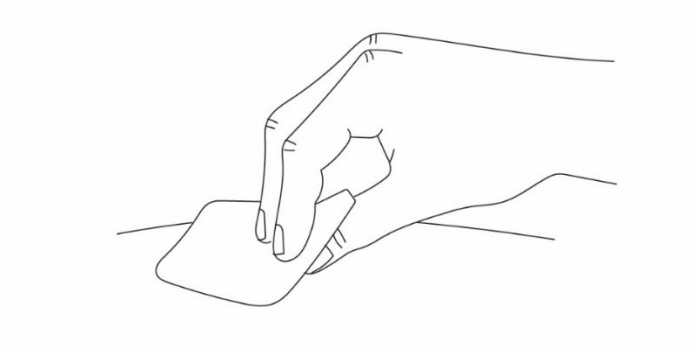

Paso 14
Deseche (elimine) el autoinyector en un recipiente para desecho de objetos cortopunzantes aprobado por la FDA.

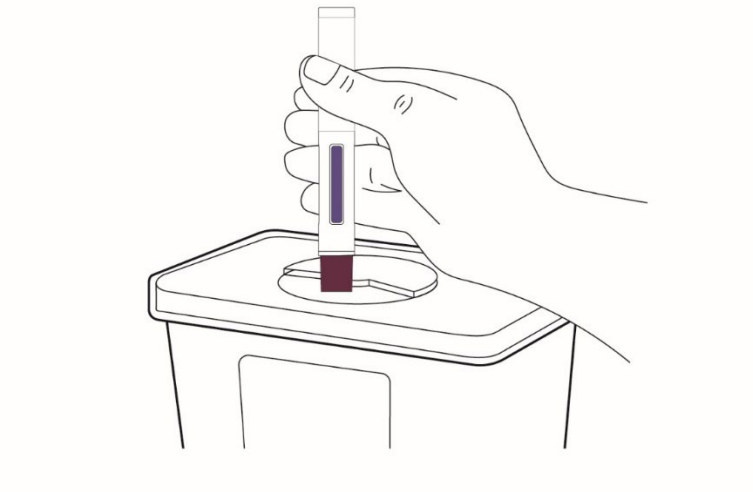

Eliminación de LEQEMBI IQLIK

No deseche (elimine) el autoinyector en la basura doméstica.

Si no tiene un recipiente para desecho de objetos cortopunzantes aprobado por la FDA, puede usar un recipiente doméstico que cumpla estos requisitos:

- esté hecho de plástico de alta resistencia;
- se pueda cerrar con una tapa que cierre firmemente, resistente a los pinchazos, sin que se puedan salir los objetos punzocortantes;
- esté en posición erguida y estable durante el uso;
- sea resistente a filtraciones; y
- esté debidamente etiquetado para advertir sobre los desechos peligrosos que hay dentro del recipiente.

Cuando el recipiente para desecho de objetos cortopunzantes esté casi lleno, siga las pautas de su comunidad sobre la manera correcta de desechar (eliminar) recipientes de este tipo. Es posible que haya leyes estatales o locales sobre cómo debe desechar las agujas y jeringas usadas. Para obtener más información sobre la eliminación segura de objetos punzocortantes y para obtener información específica sobre la eliminación de objetos punzocortantes en el estado en el que vive, visite el sitio web de la FDA: http://www.fda.gov/safesharpsdisposal.

No deseche el recipiente para desecho de objetos cortopunzantes usado en la basura doméstica, a menos que las pautas de su comunidad lo permitan.

No recicle el recipiente para desecho de objetos cortopunzantes usado.

Fabricado por:
Eisai Inc.
Nutley, NJ 07110
Licencia de los EE. UU. n.º 1862
LEQEMBI® es una marca comercial registrada de Eisai R&D Management Co., Ltd.
LEQEMBI IQLIK® es una marca comercial registrada de Eisai R&D Management Co., Ltd.

© 2026 Eisai Inc. y Biogen
Para obtener más información, visite www.LEQEMBI.com o llame al 1-888-274-2378.

Estas Instrucciones de uso han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.
Revisado: 7/2026

INSTRUCCIONES DE USO

LEQEMBI IQLIK® (leh-kem'-bi ai-klik)
(lecanemab-irmb)
de 250 mg/1.25 ml,

inyección para uso subcutáneo,
autoinyector precargado de dosis única

Estas Instrucciones de uso contienen información sobre cómo preparar y usar LEQEMBI IQLIK de 250 mg/1.25 ml.

Antes de cada uso de LEQEMBI IQLIK

Lea estas Instrucciones de uso antes de comenzar a usar LEQEMBI IQLIK y cada vez que renueve su receta. Puede haber información nueva. Esta información no reemplaza la conversación con su proveedor de atención médica sobre su afección médica y su tratamiento.

Después de la administración de al menos 2 dosis consecutivas de LEQEMBI IQLIK con la orientación directa de su proveedor de atención médica, se decidirá si es adecuado que sea usted o un cuidador quien administre LEQEMBI IQLIK. Su proveedor de atención médica debe mostrarle a usted o a un cuidador cómo usar LEQEMBI IQLIK de la manera correcta antes de la primera administración. Si tiene alguna pregunta sobre cómo usar el autoinyector, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Información importante

- LEQEMBI IQLIK solo se administra como inyección debajo de la piel (subcutánea).
- Utilice 2 de los autoinyectores de 250 mg/1.25 ml para administrar una dosis total de 500 mg.
- **No** reutilice el autoinyector.
- **No** retire la tapa transparente hasta que esté listo para aplicar la inyección.
- **No** intente desarmar el autoinyector en ningún momento.
- **No** aplique la inyección a través de la ropa.
- **No** agite el autoinyector.
- **No** use el autoinyector si la caja o cualquier pieza parecen tener daños o si se han caído.
- **No** sostenga el autoinyector por la tapa de la aguja de color gris claro.


Almacenamiento de LEQEMBI IQLIK

- Almacene el autoinyector LEQEMBI IQLIK en un refrigerador entre 36 °F y 46 °F (entre 2 °C y 8 °C).
- **No** congelar.
- Mantenga el autoinyector LEQEMBI IQLIK en la caja original hasta que esté listo para usar, para protegerlo de la luz.
- LEQEMBI IQLIK se puede almacenar a temperatura ambiente hasta 77 °F (25 °C) durante un máximo de 14 días en la caja original. **No** lo vuelva a guardar en el refrigerador si se ha llevado a temperatura ambiente.
- Deseche (elimine) el LEQEMBI IQLIK que esté vencido o si no se almacenó de la manera correcta.
- Mantenga el autoinyector LEQEMBI IQLIK y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

El autoinyector LEQEMBI IQLIK de 250 mg


Para administrar la dosis completa de 500 mg que le recetaron, debe colocarse 2 inyecciones. Administre las inyecciones juntas, una inmediatamente después de la otra.

Antes de usar

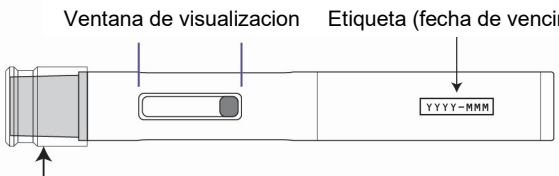

Tapa transparente y tapa de la aguja.
No destape hasta que esté listo para aplicar la inyección.

Después de usar

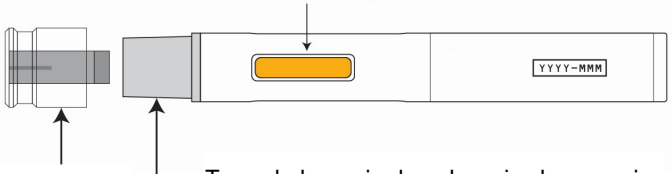

Tapa transparente

Tapa de la aguja de color gris claro; aguja en el interior.

Reunir los suministros

Suministros incluidos



2 autoinyectores
LEQEMBI IQLIK

Suministros no incluidos




Paño humedecido con alcohol



Trozo de algodón o gasa



Recipiente para desecho de objetos cortopunzantes



Venda adhesiva


Preparación para la inyección de LEQEMBI IQLIK

Paso 1
Retire la caja del refrigerador y **espere 20 minutos** para que los autoinyectores alcancen la temperatura ambiente. **No** intente acelerar el proceso de calentamiento de ninguna manera porque el producto puede dañarse.

Controle la caja.

- **No** usar si ya pasó la fecha de vencimiento que figura en la caja.
- **No** usar si el sello de la caja está roto.



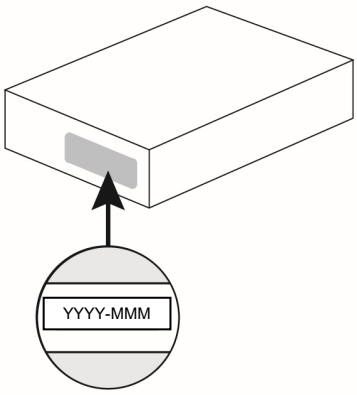

Paso 2
Verifique el autoinyector.


- **No** utilice el autoinyector si está dañado o si se ha caído.

Verifique la ventana de visualización.


- **No** utilice el medicamento si tiene un aspecto turbio, presenta un cambio de color o si contiene partículas. El medicamento debe ser transparente e incoloro a amarillo pálido. Es normal ver burbujas de aire en la ventana.

Verifique la fecha de vencimiento.

- **No** usar si ya pasó la fecha de vencimiento del autoinyector.

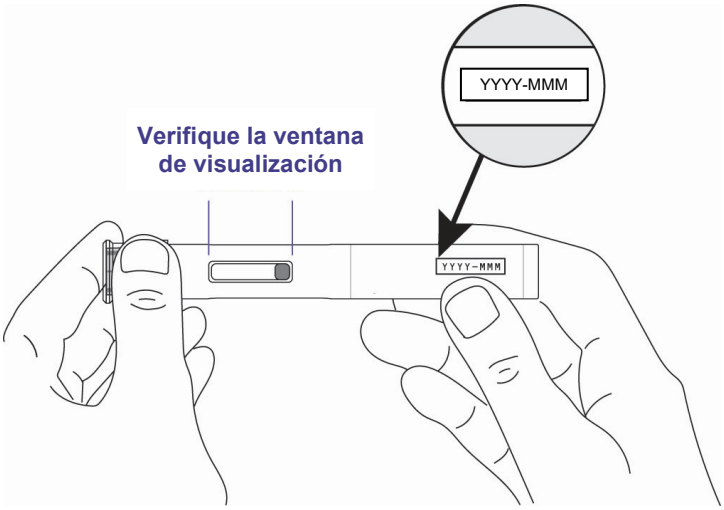


Paso 3
Lávese las manos con agua y jabón o use desinfectante para manos.

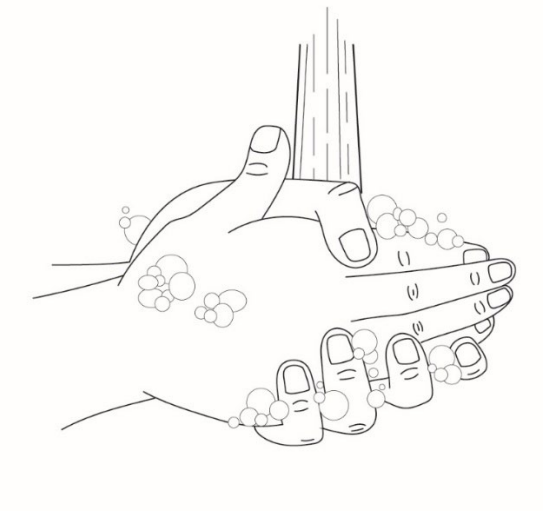

Paso 4
Puede inyectarse en la parte delantera de los muslos o en el área del estómago (abdomen). Si un proveedor de atención médica o un cuidador le administra la inyección, también puede hacerlo por detrás de la parte superior del brazo.

- **No** aplique la inyección sobre lunares, cicatrices, moretones, tatuajes o en zonas donde la piel esté enrojecida, endurecida, sensible o lesionada.
- Utilice otro lugar de inyección a 1 pulgada, como mínimo, del último lugar cada vez que use LEQEMBI IQLIK.
- **No** aplique la inyección en el área de 2 pulgadas alrededor del ombligo.

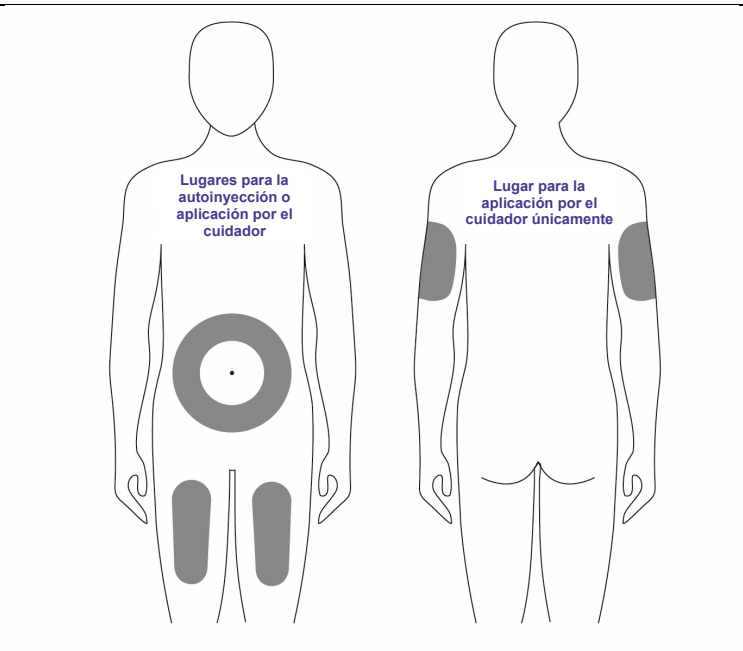

Lugares para la autoinyección o aplicación por el cuidador
Lugar para la aplicación por el cuidador únicamente

Inyección de LEQEMBI IQLIK

Paso 5

Limpie el lugar de la inyección con un paño humedecido con alcohol y deje que la piel se seque al aire.

- **No** toque el lugar de la inyección después de limpiarlo.
- **No** abanique ni sople en el área limpia.

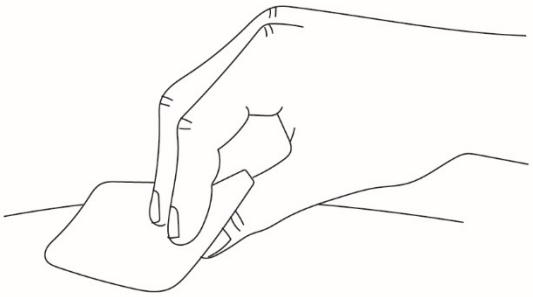


Paso 6


Retire la tapa transparente cuando esté listo para aplicar la inyección.

Sostenga el autoinyector con una mano y retire firmemente la tapa transparente tirando recto con la otra mano.

- **No** doble ni gire la tapa transparente mientras la retira.
- **No** coloque los dedos ni la mano sobre la aguja. Hacer esto puede provocar una lesión con la aguja.
- **No** vuelva a colocar la tapa transparente después de que la haya retirado del autoinyector.

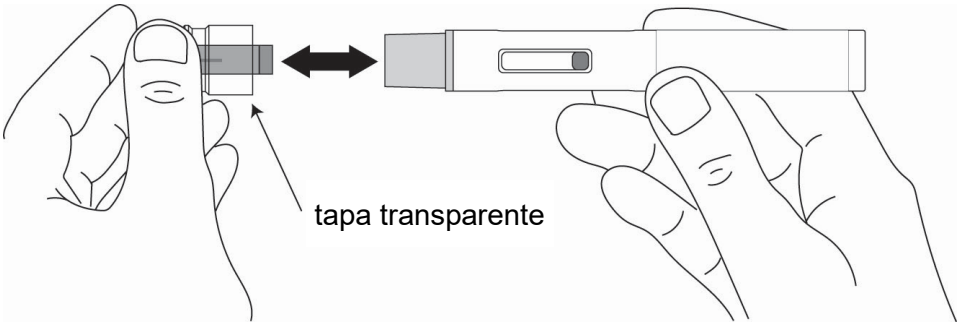


Paso 7
Deseche (elimine) la tapa en la basura doméstica o en el recipiente para desecho de objetos cortopunzantes.

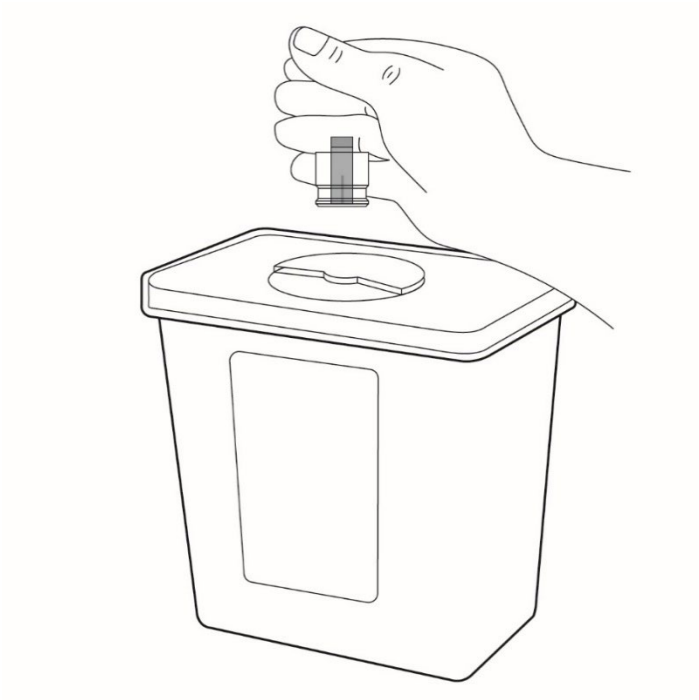

Paso 8
Coloque la tapa de la aguja de color gris claro en un ángulo de 90 grados contra la piel. Asegúrese de poder ver la ventana de visualización.

- **No** aplique la inyección a través de la ropa.

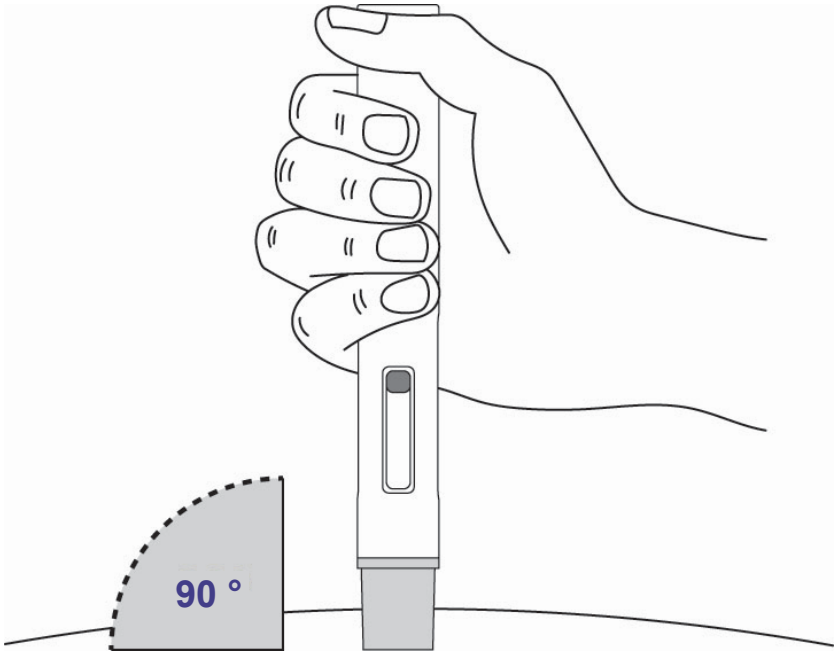


Paso 9
Empuje el autoinyector firmemente contra la piel para iniciar la inyección.

La inyección comenzará automáticamente.


- Es posible que escuche un primer “clic” que indica el inicio de la inyección.
- Durante la inyección, el vástago del émbolo amarillo se moverá hacia abajo en la ventana de visualización.

Si no escucha el clic, observe el vástago del émbolo amarillo mientras se mueve hacia abajo.

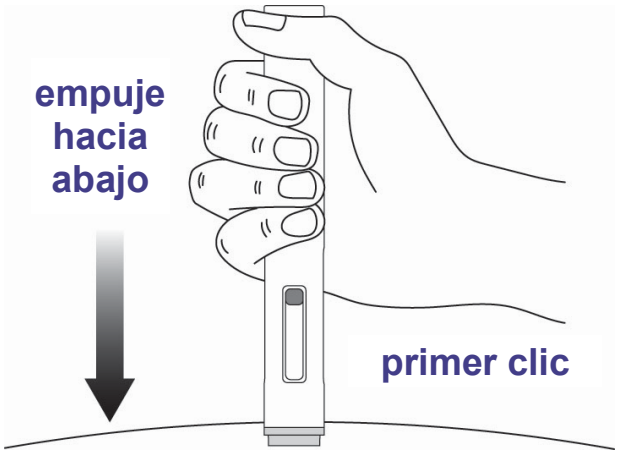


Paso 10
Continúe sosteniendo el autoinyector contra la piel durante aproximadamente **10 segundos**. Escuchará un segundo clic. El vástago del émbolo amarillo llenará la ventana de visualización.

La inyección está completa, pero continúe sosteniendo el autoinyector.

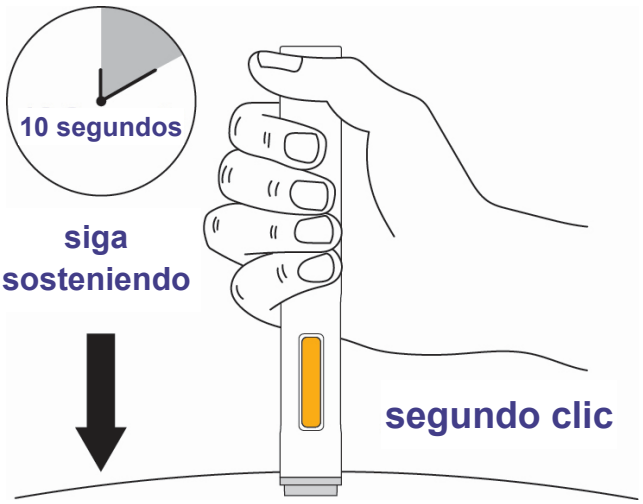


Paso 11
Mantenga el autoinyector en su lugar **durante al menos 5 segundos más** después de que termine la inyección.

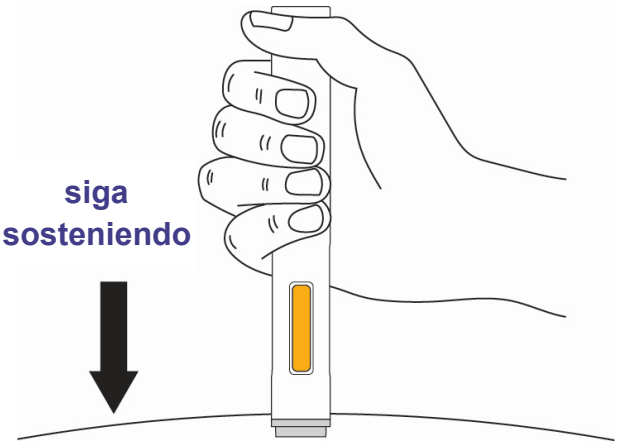


Paso 12
Retire el autoinyector tirando de él hacia arriba respecto del lugar de la inyección.

- La tapa de la aguja de color gris claro se moverá automáticamente a su lugar para cubrir la aguja.

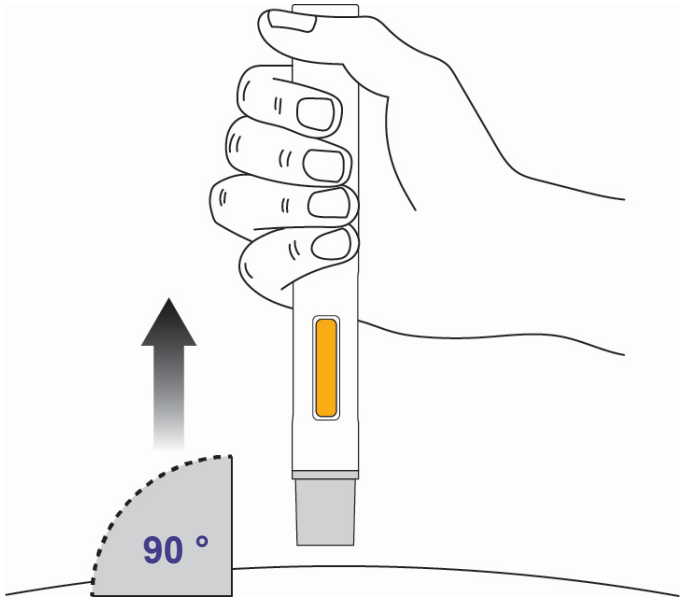

Paso 13
Es posible que note una pequeña gota de sangre en el lugar de la inyección. Esto es normal. Presione el área con un trozo de algodón o gasa.

- Si es necesario, cubra el lugar de la inyección con una venda adhesiva.
- **No** frote el lugar de la inyección.

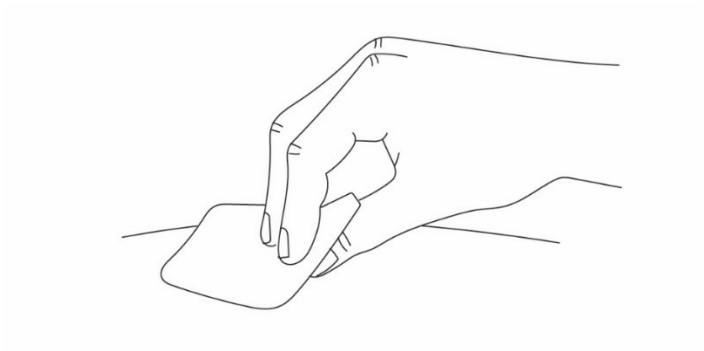

Consulte su receta. Debe usar 2 autoinyectores para administrar la dosis completa.

Repita los pasos 5 a 13.


- Utilice el segundo autoinyector inmediatamente después del primero para administrarse la dosis completa.

No inyecte a menos de 1 pulgada del lugar de la última inyección.

Póngase en contacto con su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta.

Paso 14

Deseche (elimine) los autoinyectores en un recipiente para desecho de objetos cortopunzantes aprobado por la FDA.

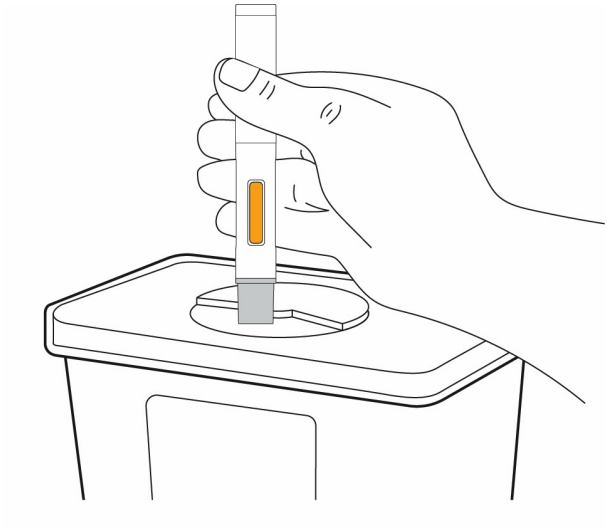

Eliminación de LEQEMBI IQLIK

No deseche (elimine) el autoinyector en la basura doméstica.

Si no tiene un recipiente para desecho de objetos cortopunzantes aprobado por la FDA, puede usar un recipiente doméstico que cumpla estos requisitos:

- esté hecho de plástico de alta resistencia;
- se pueda cerrar con una tapa que cierre firmemente, resistente a los pinchazos, sin que se puedan salir los objetos punzocortantes;
- esté en posición erguida y estable durante el uso;
- sea resistente a filtraciones; y
- esté debidamente etiquetado para advertir sobre los desechos peligrosos que hay dentro del recipiente.

Cuando el recipiente para desecho de objetos cortopunzantes esté casi lleno, siga las pautas de su comunidad sobre la manera correcta de desechar (eliminar) recipientes de este tipo. Es posible que haya leyes estatales o locales sobre cómo debe desechar las agujas y jeringas usadas. Para obtener más información sobre la eliminación segura de objetos punzocortantes y para obtener información específica sobre la eliminación de objetos punzocortantes en el estado en el que vive, visite el sitio web de la FDA: http://www.fda.gov/safesharpsdisposal.

No deseche el recipiente para desecho de objetos cortopunzantes usado en la basura doméstica, a menos que las pautas de su comunidad lo permitan.

No recicle el recipiente para desecho de objetos cortopunzantes usado.

Fabricado por: Eisai Inc.
Nutley, NJ 07110
Licencia de los EE. UU. n.º 1862
LEQEMBI® es una marca comercial registrada de Eisai R&D Management Co., Ltd.
LEQEMBI IQLIK® es una marca comercial registrada de Eisai R&D Management Co., Ltd.

© 2026 Eisai Inc. y Biogen
Para obtener más información, visite www.LEQEMBI.com o llame al 1-888-274-2378.

Estas Instrucciones de uso han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.
Aprobado: 7/2026

LEQE-US5811